




Meditech Europe

Instrukcja obsługi

MWO-AKCESORIA (do oscylatora MultiWave)

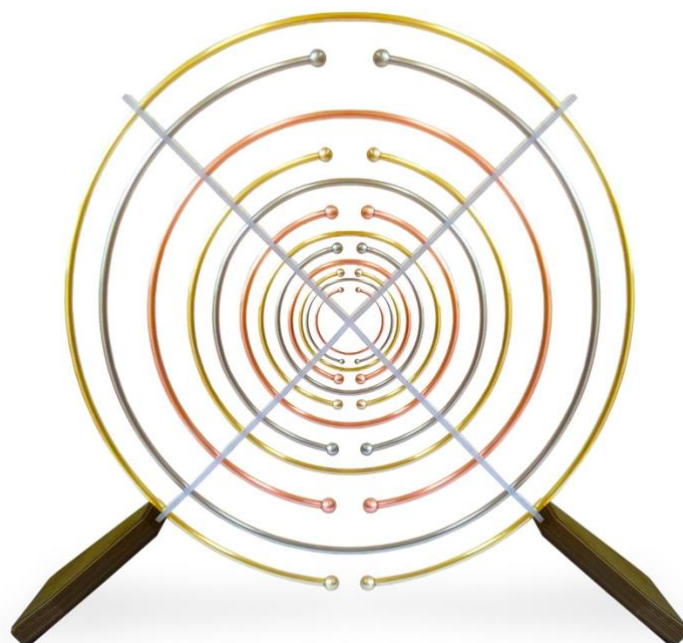

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Wersja PL V1 2024/01



Meditech Europe

Live in Harmony

Dane dotyczące projektu	: styczeń 2024 r.
Nazwa handlowa	: Meditech Europe B.V.
Nazwa produktu	: MWO-akcesoria (do oscylatora MultiWave)
Numer produktu	: różne
Wzór	: różne
Moc	: różne
Producent	: Meditech Europe B.V.
Autor	: J.K.
Adres	: Daalder 14 8305 BE Emmeloord Holandia Telefon: 0031 (0)527 292331 www.meditecheurope.nl info@meditecheurope.nl VAT NL859592480B01
Indeks poprawek	: V1
Data poprawek	: 2024/01



Spis treści

1	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
1.1	Ogólne	5
1.2	Znaki ostrzegawcze.....	5
2	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	6
2.1	Podstawowe zasady.....	6
2.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	6
2.3	Wybór i kwalifikacje personelu	6
2.4	Przepisy bezpieczeństwa	7
2.5	Rozbudowa i przekształcenie.....	7
2.6	Środki stosowane w nagłych wypadkach	7
3	Zakres dostawy.....	8
4	Opis techniczny	9
4.1	Informacje ogólne	9
4.2	Interfejs użytkownika	9
4.3	Tabliczki znamionowe	9
5	Transport	10
5.1	Przed transportem	10
5.2	Rozpakowywanie produktów.....	10
6	Obsługa	11
6.1	Podłączanie produktu	11
6.2	Obsługa oscylatora MultiWave z podłączonymi akcesoriami.....	12
6.3	Odłączenie produktu	13
7	Opcje połączeń	14



7.1	Opcja połączenia 1	14
7.2	Opcja połączenia 2	15
7.3	Opcja połączenia 3	16
7.4	Opcja połączenia 4	17
7.5	Opcja połączenia 5	18
7.6	Opcja połączenia 6	19
7.7	Opcja połączenia 7	20
7.8	Opcja połączenia 8	21
7.9	Opcja połączenia 9	22
7.10	Opcja połączenia 10	23
8	Pomoc w razie awarii	24
9	Wycofanie z eksploatacji	25
10	Gwarancja.....	26
11	Deklaracja zgodności WE.....	27



1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi

Niniejszą instrukcję obsługi należy przeczytać przed pierwszym użyciem akcesoriów MWO lub przed przystąpieniem do ich obsługi przez autoryzowanego technika. W razie pytań prosimy o kontakt z Meditech Europe.

Należy zwrócić szczególną uwagę na rozdział 2 „Ogólne zasady bezpieczeństwa”.

1.1 Ogólne

Instrukcje zawarte w tej broszurze mają na celu zapoznanie Cię z akcesoriami MWO i zapewnienie optymalnego wykorzystania ich funkcji.

Instrukcja obsługi zawiera ważne uwagi dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi oraz użytkowania akcesoriów MWO. Przyczynia się to do:

- Uniknięcia zagrożeń
- Uniknięcia kosztów napraw i przestojów
- Zwiększonej niezawodności i trwałości

Niniejsza instrukcja powinna zostać przeczytana i zastosowana przez każdą osobę upoważnioną do wykonywania prac przy akcesoriach MWO, która ukończyła 21 lat.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy również przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska, obowiązujących w kraju użytkowania i miejscu zastosowania.

1.2 Znaki ostrzegawcze

W odpowiednich miejscach znajdują się specjalne instrukcje bezpieczeństwa. Można je rozpoznać po następującym symbolu:



Promieniowanie niejonizujące

Oznacza to, że produkt emituje niskoenergetyczne promieniowanie fal radiowych i częstotliwości radiowych.



2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Podstawowe zasady

W razie wątpliwości co do prawidłowej instalacji należy zawsze skontaktować się z Meditech Europe.

Nie należy samodzielnie demontować produktów. Powinien to zrobić wyłącznie specjalista z Meditech Europe. Gwarancja traci ważność, jeśli produkt został zdemontowany przez osoby inne niż specjaliści Meditech Europe.

Aksesoria MWO mogą wytwarzać częstotliwości. Z używania akcesoriów MWO nie można wywodzić żadnych praw, ani też nie można zgłaszać żadnych roszczeń w wyniku ich użytkowania. Użytkowanie odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt użytkownika.

Aby wyczyścić akcesoria MWO: odłącz produkt od oscylatora MultiWave. Używaj suchej szmatki. W przypadku uporczywych plam można użyć wilgotnej szmatki. Upewnij się, że złącza nie uległy zamoczeniu. Do czyszczenia miedzi można stosować pastę do miedzi.

W razie wątpliwości dotyczących użytkowania, włączania i/lub ustawiania akcesoriów MWO należy zawsze kontaktować się z firmą Meditech Europe BV pod numerem telefonu: 0031 (0)527 292331 lub e-mail: info@meditecheurope.nl.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i nieprawidłowe użycie lub jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem innym niż opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku sporów obowiązuje prawo holenderskie.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Aksesoria MWO mogą wytwarzać częstotliwości.

2.3 Wybór i kwalifikacje personelu

Aksesoria MWO są produkowane przez Meditech Europe w Emmeloord (NL). Meditech Europe zatrudnia wyłącznie dobrze wyszkolonych pracowników.



2.4 Przepisy bezpieczeństwa

Nie zbliżaj się do włączonych akcesoriów MWO, jeśli masz rozrusznik serca, wszczepiony kardiowerter-defibrylator (ICD), pompę insulinową lub aparaty słuchowe.

Wszystkie akcesoria dostępne w Meditech Europe mogą być podłączane do oscylatora MultiWave na własne ryzyko klienta.

Oscylator MultiWave z akcesoriami MWO nie może być używany bez nadzoru.

Akcesoriów MWO należy zawsze używać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Umieść akcesoria MWO tak, aby z każdej strony było co najmniej 30 centymetrów wolnej przestrzeni i aby inne materiały nie miały kontaktu z akcesoriami MWO.

Należy uważać, aby akcesoria MWO nie miały kontaktu ze źródłami ciepła, takimi jak kominki, grzejniki gazowe, otwarty ogień itp.

Wszystkie przewody muszą zwisać swobodnie i nie stykać się z metalem, akcesoriami MWO, częściami przewodów ani oscylatorem MultiWave.

Nie używaj akcesoriów MWO na zewnątrz.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za nadużycia i nieprawidłowe użycie lub jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania innego niż opisane w tej instrukcji.

W przypadku użycia akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez Meditech Europe, gwarancja utraci ważność.

Dostępność akcesoriów może ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.meditecheurope.nl

2.5 Rozbudowa i przekształcenie

Oscylator MultiWave musi być odłączony od zasilania, jeśli akcesoria MWO są podłączone lub gdy zostaną odłączone.

2.6 Środki stosowane w nagłych wypadkach

Gdy wybuchnie pożar, użyj gaśnicy odpowiedniej dla sprzętu elektronicznego.



3 Zakres dostawy

Dostępnych jest wiele akcesoriów MWO.

Zdjęcia różnych typów są dostępne na stronie internetowej Meditech Europe.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać wszystkie informacje: www.meditech europe.nl



4 Opis techniczny

4.1 Informacje ogólne

Akcesoria MWO mogą wytwarzać częstotliwości po podłączeniu do oscylatora MultiWave.

4.2 Interfejs użytkownika

Akcesoria można podłączyć do oscylatora MultiWave za pomocą kabli. Urządzenie transportuje napięcie przez przewody.

4.3 Tabliczki znamionowe



Rys. 4.3 Tabliczki znamionowe przykład - różni się w zależności od akcesorium

Producent	: Meditech Europe
Dane Akcesoria MWO	: Typ i zasilanie
Numer serii	: Unikalny dla każdej serii



5 Transport

Z akcesoriami MWO należy obchodzić się ostrożnie.

5.1 Przed transportem

Meditech Europe starannie pakuje akcesoria MWO, gdy mają one zostać przetransportowane lub odebrane.

5.2 Rozpakowywanie produktów

Akcesoria MWO należy rozpakowywać ostrożnie, bez użycia ostrych narzędzi.



6 Obsługa

6.1 Podłączanie produktu

Upewnij się, że oscylator MultiWave nie jest podłączony do gniazda zasilania.

Podłącz przewody do złącza oscylatora MultiWave. Upewnij się, że oba wyjścia MWO są używane. Jeśli używane jest tylko jedno wyjście lub nie ma żadnego wyjścia, MWO nie będzie w stanie rozproszyć swojej mocy i może ulec uszkodzeniu.

Podłącz przewód do akcesoriów MWO, jeśli przewód został dostarczony luzem.


Anteny; metal może wpływać na pole energetyczne. Upewnij się, że odstęp pomiędzy antenami wynosi od 100 do 180 cm.

Użyj jarzeniówki, aby uwidocznić pole energetyczne anten. Widoczne staje się również pole energetyczne poduszki i anteny na płycie drukowanej. Włącz MWO i przytrzymaj rurkę pomiędzy antenami (lub blisko poduszki). Jarzeniówka może być również używana do sprawdzenia, czy pole energii jest stałe i równomierne, czy też migocze. Dostosowując precyzyjne dostrojenie, można dosłownie zobaczyć, jak zmienia się pole energetyczne.





Poduszka; w celu dodania poduszki bez zmniejszania mocy anten. Umieść poduszkę na ziemi pomiędzy antenami, nie podłączając kabla poduszki. Pole energetyczne anten aktywuje poduszkę, ponieważ kabel "absorbuje" energię pomiędzy antenami.

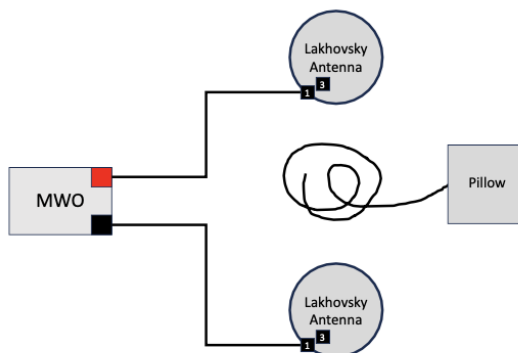

Antena płytki drukowanej; zachowaj odległość 30 cm między obiektem a płytką drukowaną.

Rife Tube; wtyczka Rife Tube może być włożona w pobliżu wtyczki anteny, do otworu we wtyczce prowadzącej z MWO do anten. Moc jest dzielona pomiędzy Rife Tube i anteny.

Uwaga: skuteczność obu akcesoriów spada!



6.2 Obsługa oscylatora MultiWave z podłączonymi akcesoriami

Główne przyciski na MWO to Fine Tuning i Pulse Strength. Za ich pomocą można dostosować moc MWO i regulować dźwięk urządzenia.



Dzięki Pulse Strength dosłownie „otwierasz” iskiernik, co powoduje dźwięk iskier mechanicznych. Im bardziej obracasz Pulse Strength w prawo, tym szerzej otwierasz iskiernik i tym głośniejszy będzie dźwięk iskier.

Należy pamiętać, że Pulse Strength może być obracany tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara! Jeśli więc MWO jest zbyt głośne i chcesz je zmniejszyć, przekręć pokrętło Pulse Streenght w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż iskiernik ponownie się otworzy.

Dzięki funkcji Fine Tuning określasz „rytm” iskier. Dźwięk iskier (dźwięk iskier mechanicznych) będzie się zmieniać w miarę zwiększania poziomu (Fine Tuning) dostrajania. Efektem działania tego przycisku jest uspokojenie i ustabilizowanie pola energetycznego. Dźwięk iskiernika powinien być stały, bez zbyt wielu zakłóceń.

6.3 Odłączenie produktu

Upewnij się, że oscylator MultiWave nie jest podłączony do gniazda zasilania.

Odłącz przewody od złącza oscylatora MultiWave.




7 Opcje połączeń

7.1 Opcja połączenia 1

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Anteny
- 1 Zestaw przewodów

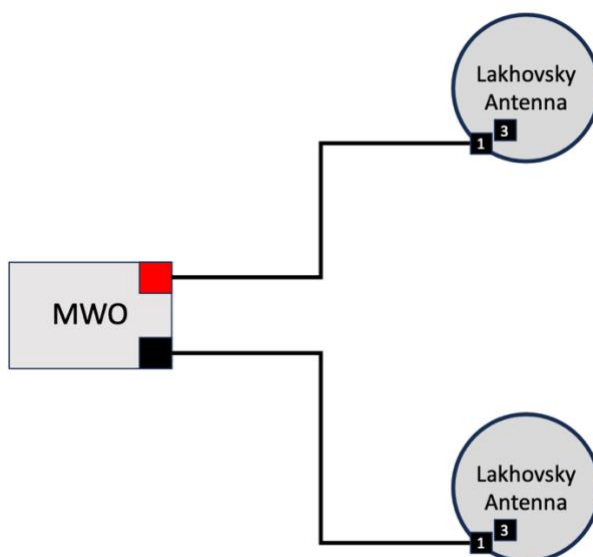

Efekt; podłącz MWO do zewnętrznego pierścienia anten (1).
Najsilniejsze możliwe pole energetyczne pochodzące z anten.
Dostępny jest pełen zakres częstotliwości.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO znajdują się na niskim poziomie. Pole energetyczne jest wtedy również aktywne.



7.2 Opcja połączenia 2

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Anteny
- 1 Zestaw przewodów

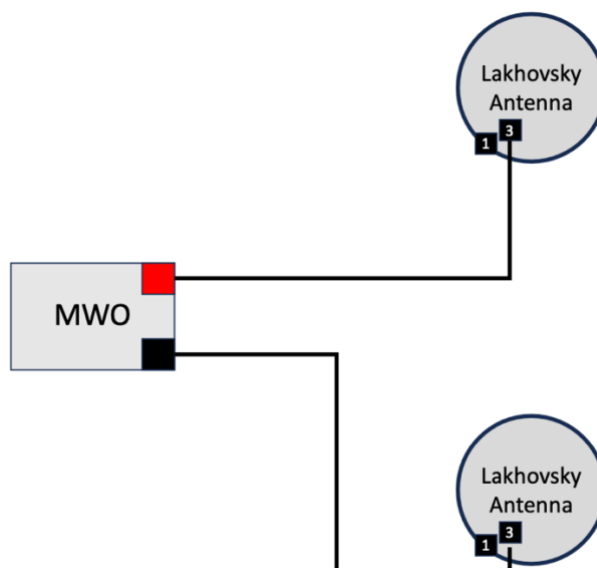

Efekt; podłącz MWO do trzeciego pierścienia anten (3). Nieco łagodniejsze pole energetyczne pochodzące z anten. Zakres częstotliwości pozostaje dostępny, dolny zakres częstotliwości jest mniej intensywny.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO znajdują się na niskim poziomie. Pole energetyczne jest wtedy również aktywne.



7.3 Opcja połączenia 3

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Anteny
- Rife Phanotron
- 2 Zestawy przewodów

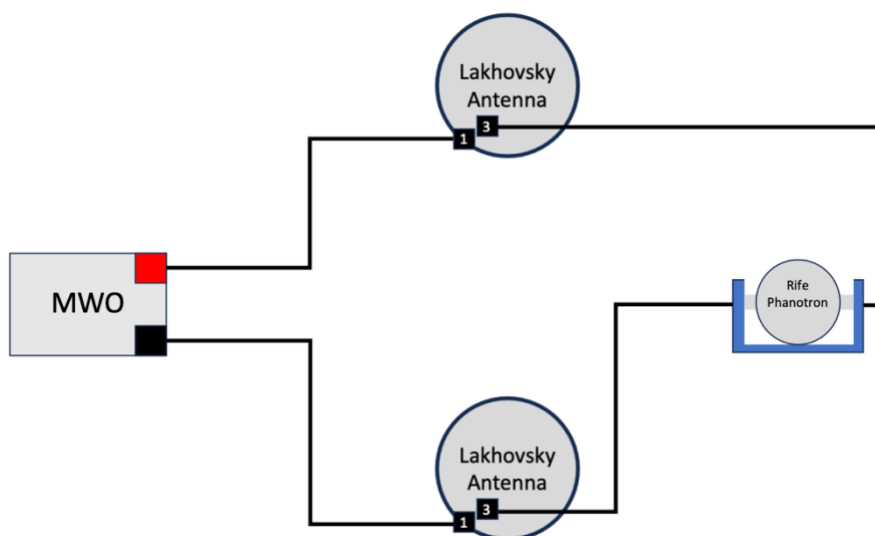

Efekt: podłącz MWO do zewnętrznego pierścienia anten, a Rife Phanotron do trzeciego pierścienia anten. Pole energetyczne pochodzące z anten uzupełniane jest przez Częstotliwości Rife. W antenach dostępny jest pełen zakres częstotliwości, natomiast Rife Phanotron pokrywa pomieszczenie, w którym się znajduje. To najsilniejszy możliwy skład.


Ustawienie MWO; MWO można ustawić na połowę jego mocy. Dzięki temu anteny pozostają aktywne, aktywując jednocześnie Rife Phanotron.



7.4 Opcja połączenia 4

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- Rife Phanotron
- 1 Zestaw przewodów

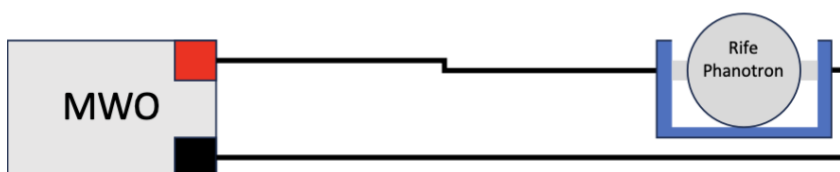

Efekt; podłącz MWO do obu złączy Rife Phanotron. Rife Phanotron jest teraz w pełni aktywowany i otrzymuje pełną moc z MWO. Częstotliwości są teraz wysyłane do otoczenia, w którym stoi, powodując rezonans wszystkiego.


Ustawienie MWO; MWO można ustawić na połowę jego mocy. Dzięki temu Rife Phanotron może optymalnie rozprzestrzeniać swoją częstotliwość.



7.5 Opcja połączenia 5

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 2 Poduszki

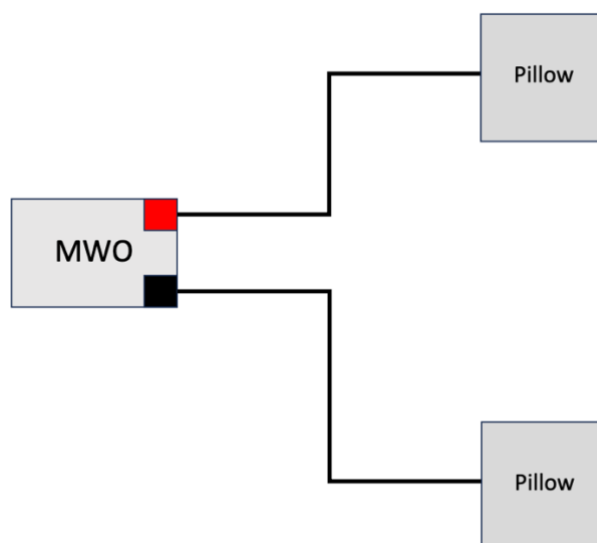

Efekt; podłącz obie poduszki do MWO. Z poduszek wydobywa się uspokajające i łagodne miejscowe pole energetyczne.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie. Poduszka potrzebuje bardzo niskiego wkładu energii z MWO, aby emitować swoje pole energetyczne.



7.6 Opcja połączenia 6

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Poduszka
- 1 Rife Tube

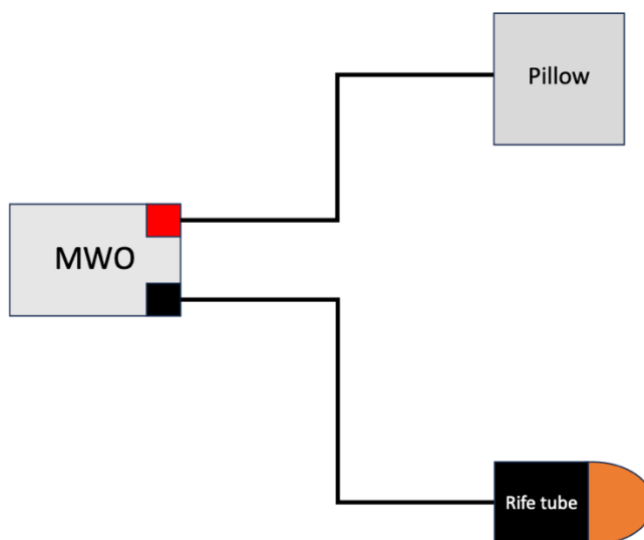

Efekt; Podłącz poduszkę i Rife Tube do MWO. Nie ma znaczenia, które wyjście jest używane dla którego akcesoria. Jest to bardzo wydajna konfiguracja do intensywnych działań lokalnych.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, w przeciwnym razie iskry pochodzące z Rife Tube mogą być nieprzyjemne.



7.7 Opcja połączenia 7

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Rife Tube
- 1 Antena na płytce drukowanej
- 1 Zestaw przewodów

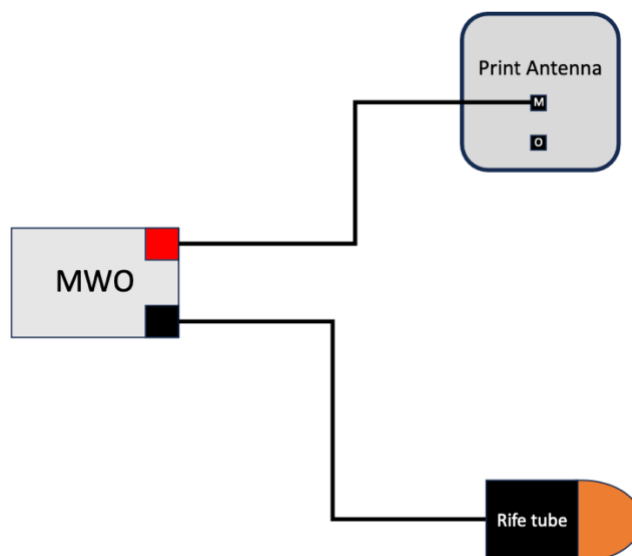

Efekt; podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) anteny na płytce drukowanej. Podłącz również Rife Tube. Silne i potężne, ale zlokalizowane pole energetyczne pochodzi z anteny płytki drukowanej. Antena na płytce drukowanej wytwarza sporo hałasu z powodu isker zapalających się pomiędzy pierścieniami. Rife Tube można używać tam, gdzie szczególnie chcesz mieć wpływ na częstotliwość. Jest to bardzo wydajna konfiguracja do intensywnych działań lokalnych.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, w przeciwnym razie iskry pochodzące z Rife Tube mogą być nieprzyjemne.



7.8 Opcja połączenia 8

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 2 Anteny na płytce drukowanej
- 1 Zestaw przewodów

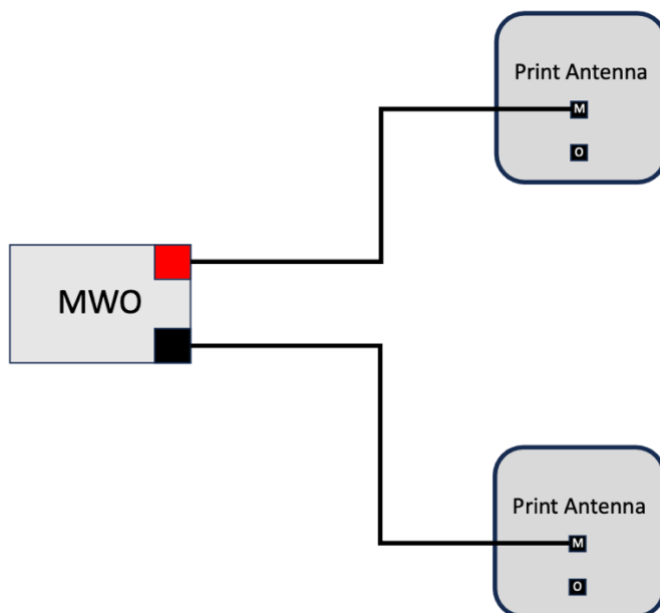

Efekt; podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) anten na płytce drukowanej. Silne i potężne, ale lokalne pole energetyczne pochodzi z anten na płytce drukowanej, które można skierować w dowolną żadaną część. Anteny na płytkach drukowanych wytwarzają sporo hałasu z powodu iskieł zapalających się pomiędzy pierścieniami.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, ponieważ w przeciwnym razie hałas iskieł pochodzących z anten na płytce drukowanej może być nieprzyjemny, podczas gdy efekt nie jest zmniejszony.



7.9 Opcja połączenia 9

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Antena na płytce drukowanej
- 1 Poduszka
- 1 Zestaw przewodów

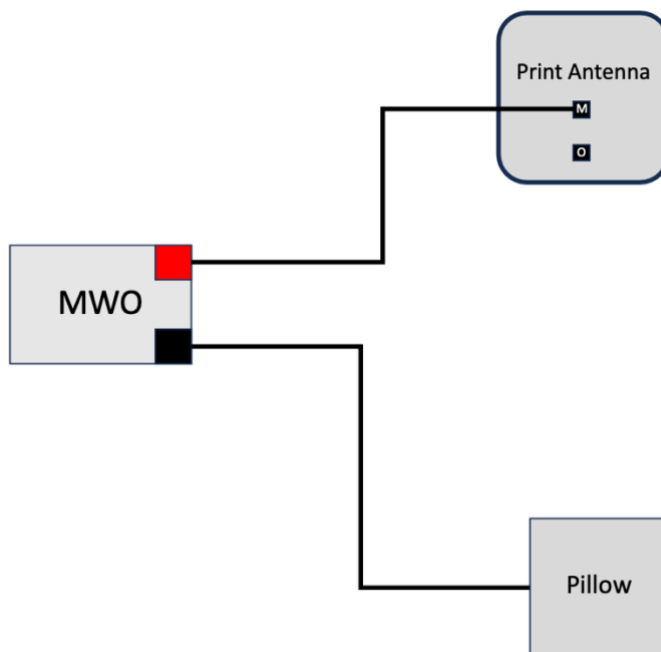

Efekt; Podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) anteny na płytce drukowanej i poduszki. Silne i potężne, ale lokalne pole energetyczne pochodzi z anteny płytki drukowanej. Antena na płytce drukowanej wytwarza sporo hałasu z powodu iskier zapalających się pomiędzy pierścieniami.

Poduszka zapewnia miękkie i gładkie pole energetyczne oraz pełni funkcję uziemiającą.


Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, w przeciwnym razie iskry pochodzące z anteny płytki drukowanej mogą być nieprzyjemne.



7.10 Opcja połączenia 10

Materiały eksploatacyjne:

- MWO
- 1 Antena na płytce drukowanej
- 1 Zestaw przewodów

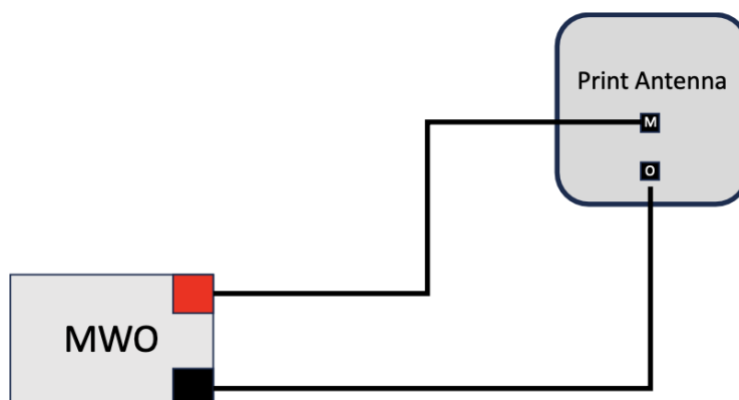

Efekt; Podłącz MWO do wewnętrznego pierścienia (M) i zewnętrznego pierścienia (O) anteny na płytce drukowanej. Silne i potężne, ale lokalne pole energetyczne pochodzi z anteny płytki drukowanej. Ponieważ cała energia pochodząca z MWO trafia do jednej anteny na płytce drukowanej, będzie ona niezwykle potężna. Antena na płytce drukowanej wytwarza sporo hałasu z powodu isker zapalających się pomiędzy pierścieniami.

Ustawienie MWO; upewnij się, że ustawienia MWO są na niskim poziomie, ponieważ hałas powodowany przez iskry wydobywające się z anteny płytki drukowanej może być nieprzyjemny.



8 Pomoc w razie awarii

Jeśli akcesoria MWO przestaną działać prawidłowo, nie należy próbować naprawiać ich samodzielnie, lecz skontaktować się z Meditech Europe.



9 Wycofanie z eksploatacji

Skontaktuj się z Meditech Europe w celu utylizacji i recyklingu akcesoriów MWO. Meditech Europe chętnie przyjmuje wszystkie produkty do utylizacji i recyklingu zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Jeśli użytkownik chce samodzielnie zutylizować produkt, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



10 Gwarancja

Meditech Europe oferuje 2-letnią gwarancję na akcesoria MWO.

Gwarancja traci ważność, jeśli jakiegokolwiek naprawy produktu zostały wykonane przez osoby inne niż specjaliści Meditech Europe.

Meditech Europe nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i nieprawidłowe użycie lub jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane użyciem innym niż opisane w niniejszej instrukcji.

Adres serwisowy

Meditech Europe B.V.

Daalder 14

8305 BE Emmeloord

Holandia

Telefon: 0031 (0)527 292331

www.meditecheurope.nl

info@meditecheurope.nl



11 Deklaracja zgodności WE

- System płyt energetycznych
- Uchwyt elektrod szklanych
- Poduszki
- Rife Tubes
- Przewody MWO / zestaw 2 sztuki
- Urządzenie ze srebrnymi elektrodami

Producent oświadcza, że powyższe produkty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i dyrektywa delegowana (UE)
2015/863

W których zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz, w stosownych przypadkach, normy i specyfikacje techniczne:

EN 50575:2014

-
- Anteny
 - Antena na płytce drukowanej
 - Rife Phanotrons

Producent oświadcza, że powyższe produkty są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE